Endress+Hauser
People for Process Automation

Durchflusskalibrierung mit Justierung

10658681-3373756

3009774674	FCP-7.1.5
Bestellnummer	Kalibrieranlage
CH-3005223435-10 / Endress+Hauser Flowtec AG	9000 kg/h (≙ 100%)
Auftragsnummer/Hersteller	Kalibrierter Endwert
80P40-2254/0	Service-Schnittstelle
Bestellcode	Kalibrierter Ausgang
PROMASS 80 P DN40 / 1 1/2"	1.8929
Umformer/Aufnehmer	Kalibrierfaktor
J80CA402000	52
Fabrikationsnummer	Nullpunkt
–	24.5 °C
Tag-Nr.	Wassertemperatur

Fluss [%]	Fluss [kg/h]	Zeit [s]	m soll [kg]	m mess. [kg]	Δ v.M.* [%]
24.9	2244.88	35.2	21.936	21.935	-0.01
25.0	2245.21	35.2	21.940	21.939	0.00
99.7	8975.97	30.2	75.231	75.227	-0.01
99.8	8978.44	30.2	75.253	75.253	0.00
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

*v.M.: vom Messwert

Messabweichung % v.M.

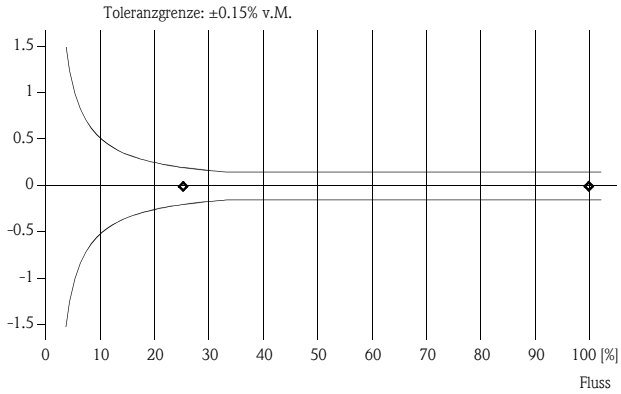

Für detaillierte Daten bezüglich Spezifikationen der Signalausgänge des Prüflings siehe Technische Information (TI), Kapitel Messgenauigkeit.

Die Rückführbarkeit aller bei der Kalibrierung verwendeten Prüfmittel auf das nationale Normal ist sichergestellt.

Endress+Hauser Flowtec betreibt in Reinach (CH), Cernay (FR), Greenwood (USA), Aurangabad (IN) und Suzhou (CN) nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Kalibrieranlagen.

28.08.2014	Z. Velickovic
Kalibrierdatum	Kalibrierer
Endress+Hauser Flowtec AG Kägenstrasse 7 / Rue de l'Europe 35 CH-4153 Reinach / F-68700 Cernay	Zertifiziert nach ISO 9001